


**COAGULAZIONE**



**ANTICOAGULANTI HYPHEN**  
**L'ECCELLENZA NEL MONITORAGGIO**  
**DEI FARMACI ANTICOAGULANTI**

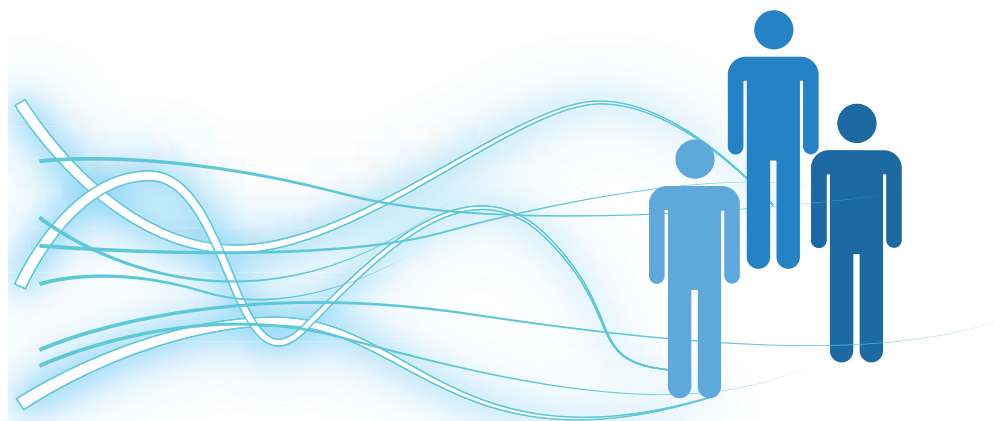

DASITGROUP



**DASIT**



## QUANDO DOSARE I FARMACI ANTICOAGULANTI



Sospetto di  
sovradosaggio



Prolungamento  
inaspettato dei  
test coagulativi



Sanguinamento in  
Terapia Intensiva o  
Pronto Soccorso



Disfunzione  
renale



Valutazione del rischio  
pre-operatorio



Nel corso di circolazioni  
extracorporee del sangue

## PERCHÈ AFFIDARSI AI REAGENTI HYPHEN BIOMED



### Standardizzazione

Risultati quantitativi in  
concentrazioni di farmaco.  
Eccellente correlazione  
con i metodi di riferimento  
(LC-MS/MS).

### Efficienza

Rapidità di esecuzione  
con le formulazioni liquide  
pronte all'uso.  
Confezionamenti ottimizzati  
per minimizzare gli sprechi.

### Specificità

Calibratori e controlli  
ottimizzati ed integrati  
con ciascun farmaco.  
Calibratori e controlli  
dedicati per intervalli di  
misura (Standard e Low).

### Automazione

Metodi standard coagulativo  
e cromogenico.  
Applicazioni validate sugli  
analizzatori automatici più  
diffusi.

## UNA SCELTA ACCURATA DEI METODI E DEI PRINCIPI DI MISURA

### HEMOCLOT Thrombin Inhibitors

Metodo coagulativo di misura del **tempo di trombina diluito** con plasma umano normale.

### BIOPHEN DTI

Metodo **cromogenico** con inibizione diretta di un **eccesso di trombina** da parte del farmaco da misurare.

### BIOPHEN DiXaI

Metodo **cromogenico** con inibizione diretta di un eccesso di **Fattore Xa umano** da parte del farmaco da misurare.

### BIOPHEN HEPARIN LRT

Metodo **cromogenico liquido pronto all'uso** con inibizione Antitrombina-mediata di un eccesso di **Fattore Xa bovino** da parte del farmaco da misurare.

- Dabigatran
- Irudina
- Argatroban®

- Rivaroxaban
- Apixaban


- Rivaroxaban
- Apixaban
- Eparina UFH e LMWH
- Orgaran®
- Arixtra®

## UNA SCELTA MIRATA ALLE ESIGENZE CLINICHE DEL PAZIENTE

### ANTICOAGULANTI A SOMMINISTRAZIONE ORALE


Gli anticoagulanti orali inibitori diretti dei fattori della coagulazione richiedono minimo monitoraggio di routine, ma estrema **attenzione e accuratezza analitica in casi di emergenza**.

I reagenti HYPHEN sono affiancati da plasmi calibranti di controllo, integrati con ciascun farmaco anticoagulante (diretti **anti-IIa** e **anti-Xa**) ed adeguati a dosare anche minimi quantitativi di farmaco circolante.

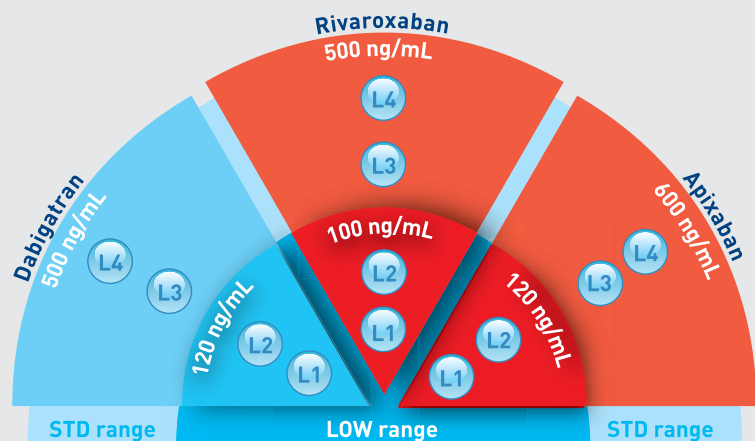


### ANTICOAGULANTI A SOMMINISTRAZIONE INTRAMUSCOLARE ED ENDOVENOSA

Gli anticoagulanti eparinici e inibitori diretti dei fattori a somministrazione intramuscolare o endovenosa sono impiegati estensivamente nelle procedure chirurgiche, anche a minima invasività. La disponibilità di un dosaggio quantitativo specifico per ciascun farmaco (diretti **anti-IIa** e **anti-Xa**) consente di **evitare interferenze e ottimizzare le posologie**.

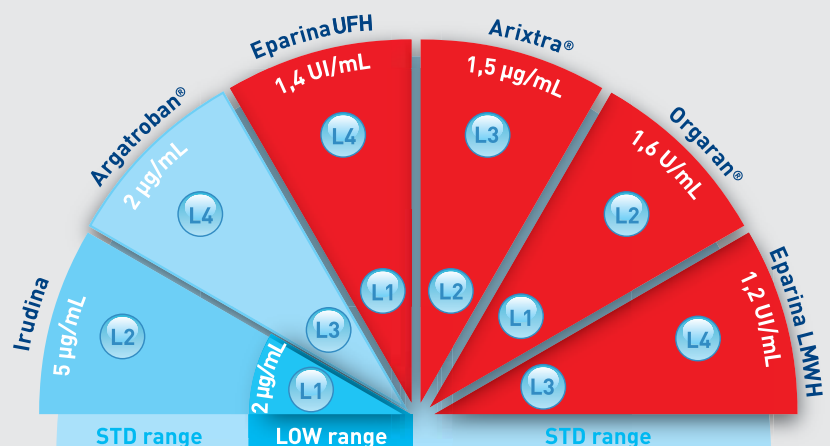



## ANTICOAGULANTI HYPHEN

CODICI	TEST	CONFEZIONAMENTO
<b>MONITORAGGIO QUANTITATIVO FARMACI ANTICOAGULANTI</b>		
K33221013	BIOPHEN HEPARIN LRT	3 x 3 mL
K33CK002L	HEMOCLLOT Thrombin Inhibitors	3 x 2,5 mL
K33CK002K	HEMOCLLOT Thrombin Inhibitors	3 x 1 mL
K33221030	BIOPHEN DiXal	3 x 2,5 mL
K33220202	BIOPHEN DTI	2 x 2,5 mL
<b>PLASMI CALIBRANTI BIOPHEN</b>		
K33222201	BIOPHEN Orgaran® Calibratore	4 x 5 x 1 mL
K33222501	BIOPHEN Arixtra® Calibratore	3 x 4 x 1 mL
K33222301	BIOPHEN UFH Calibratore	4 x 5 x 1 mL
K33222001	BIOPHEN LMWH Calibratore	4 x 5 x 1 mL
K33222801	Dabigatran Calibratore STD	4 x 3 x 1 mL
K33222901	Dabigatran Calibratore LOW	4 x 3 x 1 mL
K33SC030K	Argatroban® Calibratore	4 x 5 x 1 mL
K33SC025K	Hirudin Calibratore STD	3 x 2 x 1 mL
K33SC025L	Hirudin Calibratore LOW	3 x 2 x 1 mL
K33222701	BIOPHEN Rivaroxaban Calibratore STD	4 x 3 x 1 mL
K33226001	BIOPHEN Rivaroxaban Calibratore LOW	4 x 3 x 1 mL
K33226201	BIOPHEN Apixaban Calibratore STD	4 x 3 x 1 mL
K33226101	BIOPHEN Apixaban Calibratore LOW	4 x 3 x 1 mL
<b>PLASMI DI CONTROLLO BIOPHEN</b>		
K33223501	BIOPHEN Orgaran® Controllo	6 x 2 x 1 mL
K33224001	BIOPHEN Arixtra® Controllo	6 x 2 x 1 mL
K33223101	BIOPHEN UFH Controllo	6 x 2 x 1 mL
K33223001	BIOPHEN LMWH Controllo STD	6 x 2 x 1 mL
K33223701	BIOPHEN LMWH Controllo LOW	6 x 2 x 1 mL
K33224701	Dabigatran Controllo STD	6 x 2 x 1 mL
K33225001	Dabigatran Controllo LOW	6 x 2 x 1 mL
K33SC035K	Argatroban® Controllo	6 x 2 x 1 mL
K33SC035K	Hirudin Controllo	3 x 2 x 1 mL
K33224501	BIOPHEN Rivaroxaban Controllo STD	6 x 2 x 1 mL
K33225101	BIOPHEN Rivaroxaban Controllo LOW	6 x 2 x 1 mL
K33225301	BIOPHEN Apixaban Controllo STD	6 x 2 x 1 mL
K33225201	BIOPHEN Apixaban Controllo LOW	6 x 2 x 1 mL



DASIT S.P.A.  
VIA R. MERENDI, 22  
20010 CORNAREDO (MI)  
TEL. 02 93 991 1  
FAX 02 93 991 390  
www.dasit.it

